


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2016	管理番号	H020118
型式	VM940R	測定者	蔵内	アシスタント	仙田

振り回し(300ピッチ)

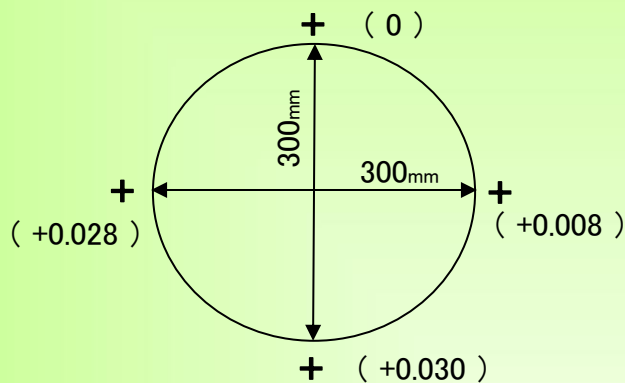

主軸振れ



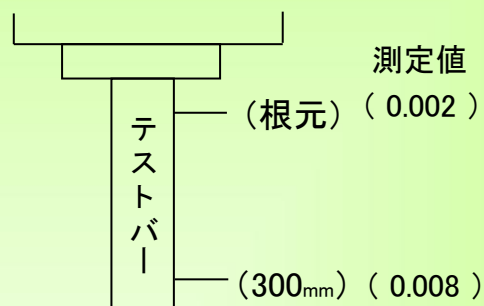


直角度

【YZ】測定値 (0.018)


【XZ】測定値 (0.026)

【X Y】測定値 (0.036)

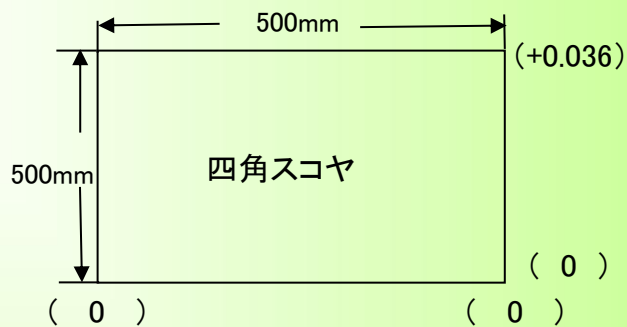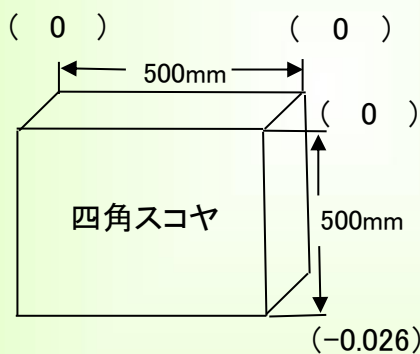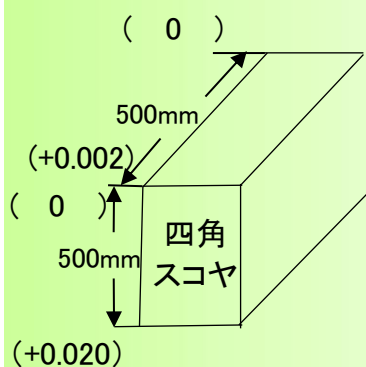

上面精度

※テーブルサイズ 940 × 2300

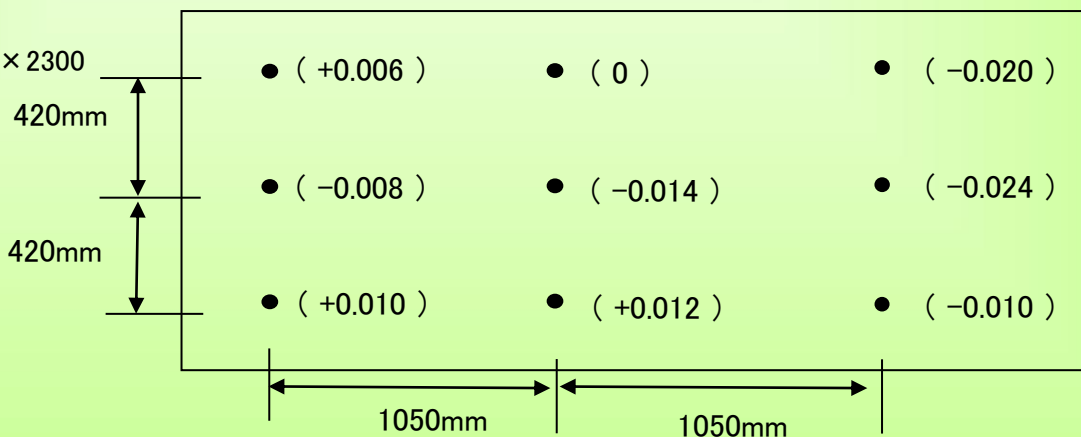

2026/9/8