


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	山崎技研	年式	2020	管理番号	H020168
型式	YZ-402SGATC	測定者	蔵内	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

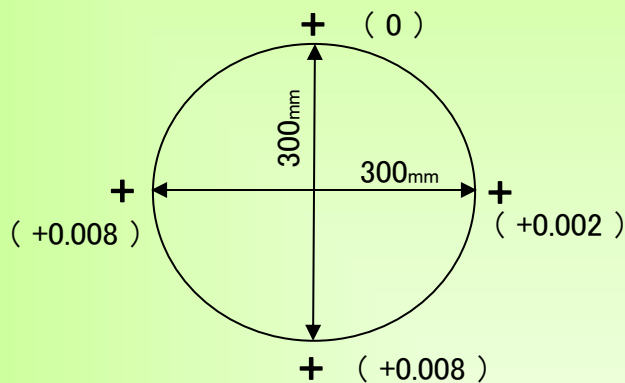

主軸振れ



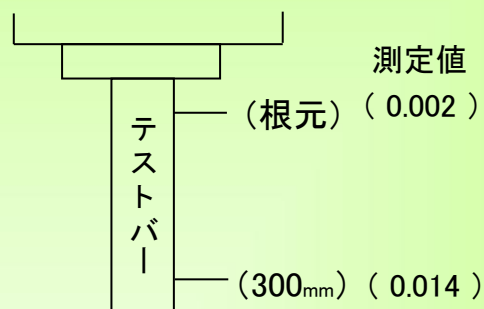


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.008)

【X Y】測定値 (0.006)

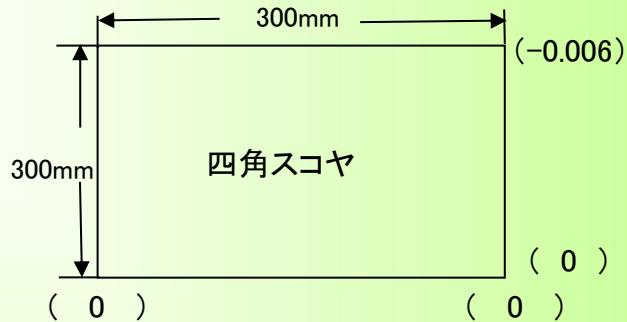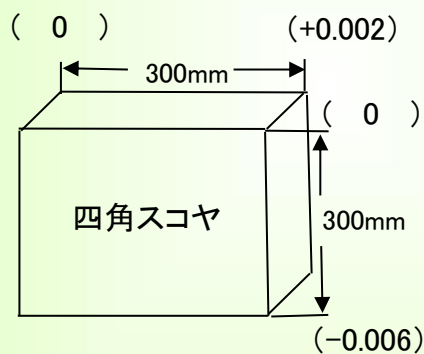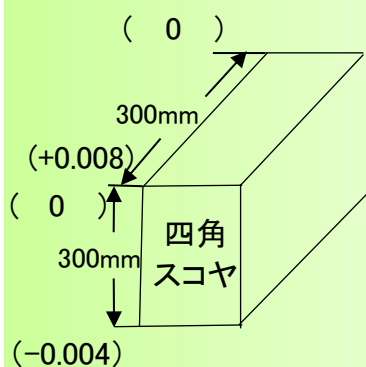

上面精度

※テーブルサイズ 1400×400

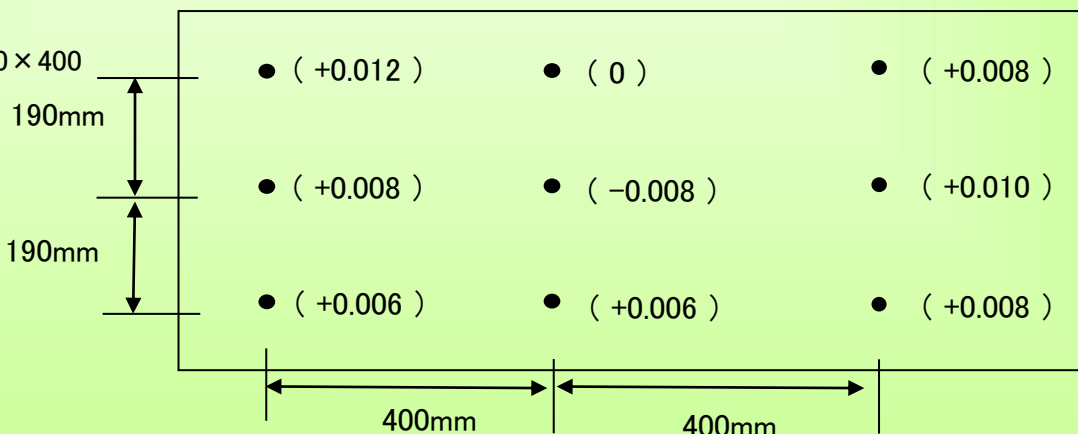

2026/9/17