
精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2005.11	管理番号	P008792
型式	α-T21iEL	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

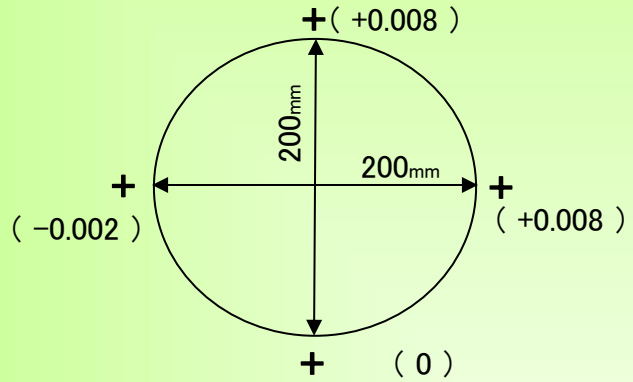



主軸振れ

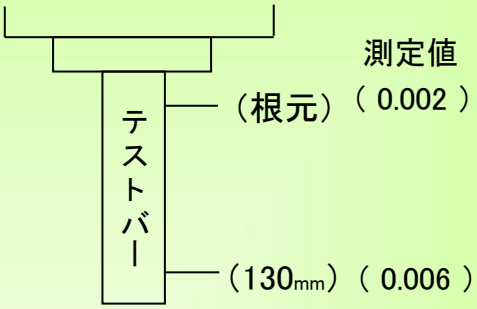

直角度

【YZ】測定値 (0.010)　【XZ】測定値 (0.002)　【X Y】測定値 (0.002)

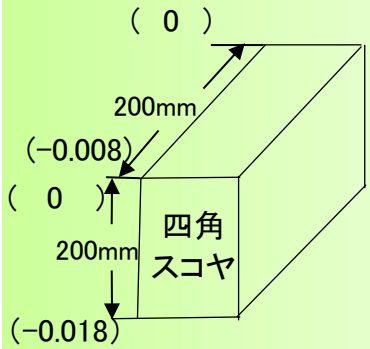

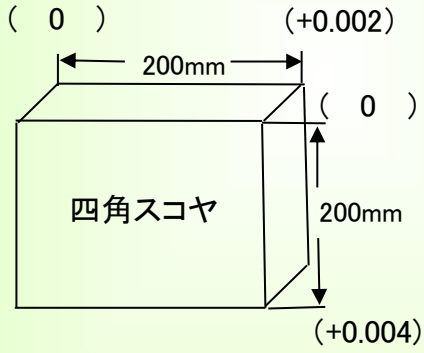




上面精度

※テーブルサイズ　410×850

【バックラッシュ測定】
X軸　0.001
Y軸　0.004
Z軸　0.002

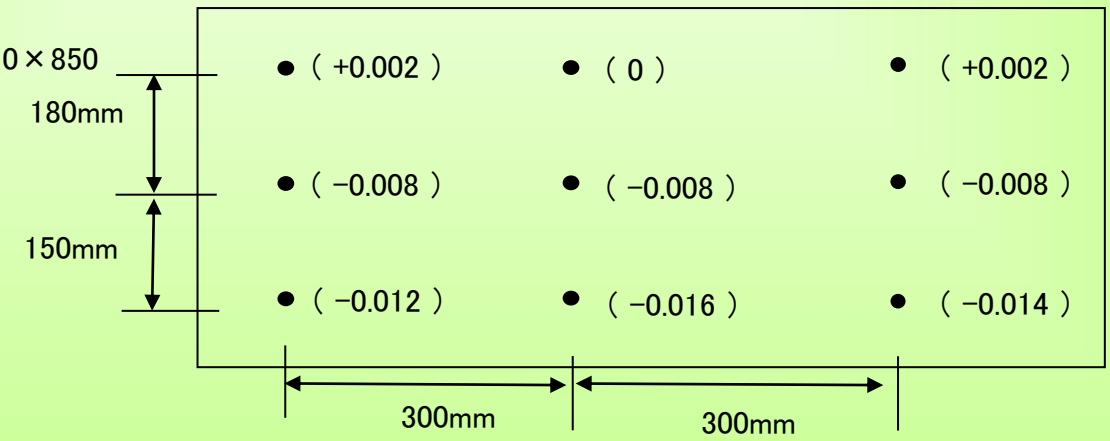

2026/10/14