
精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2007	管理番号	P009298
型式	NH5000DCG/40	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

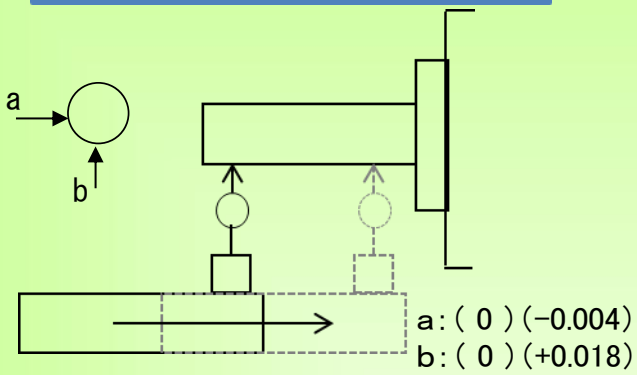


主軸振れ

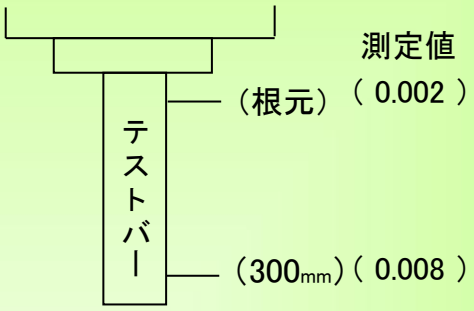


直角度

【XY】測定値 (0.004)

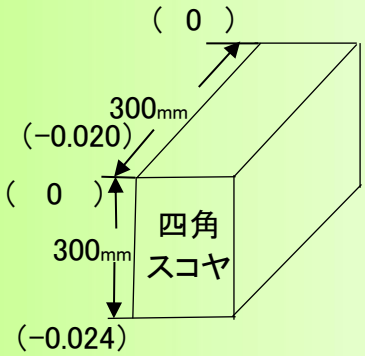

【ZY】測定値 (0.010)

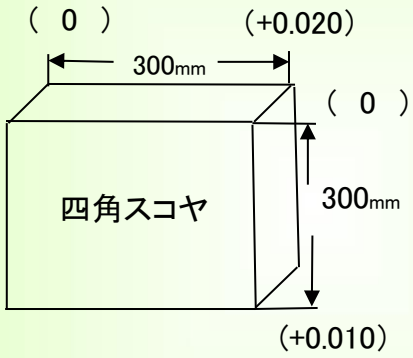


【ZX】測定値 (0.004)



上面精度

テーブルサイズ：500角
( )パレット1
[ ]パレット2

0°	: 0
90°	: -0.002
180°	: -0.006
270°	: +0.010

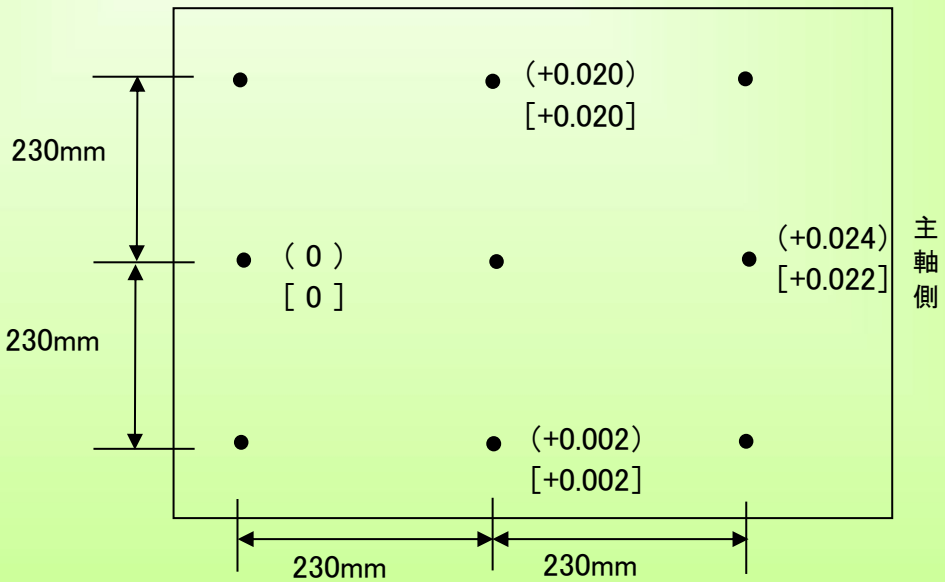

2026/10/21