
精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2005	管理番号	P009347
型式	NH5000/40	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

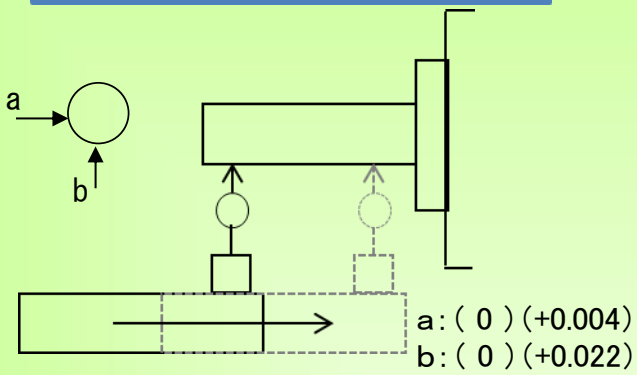


主軸振れ

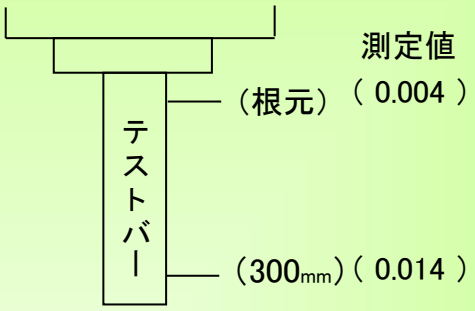


直角度


【XY】測定値 (0.010)

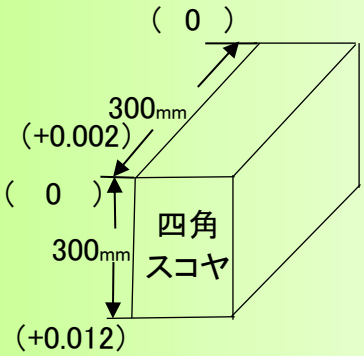

【ZY】測定値 (0.008)

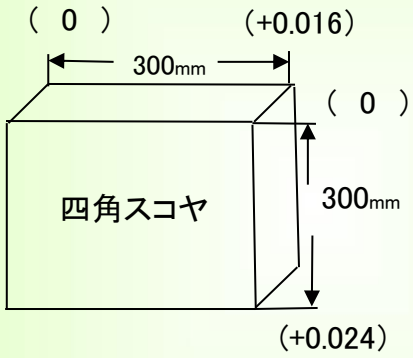


【ZX】測定値 (0.004)

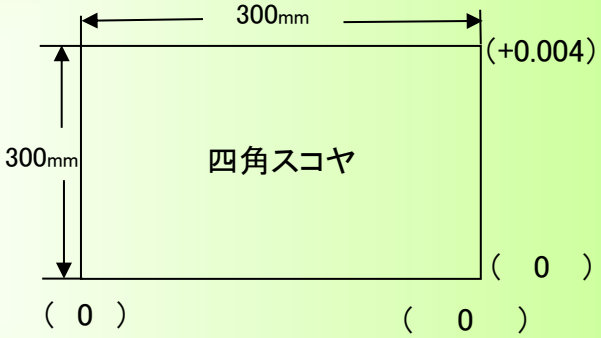

上面精度

テーブルサイズ：500角
( )パレット1
[ ]パレット2

C軸旋回精度	
0°	：0
90°	：+0.002
180°	：-0.010
270°	：-0.002

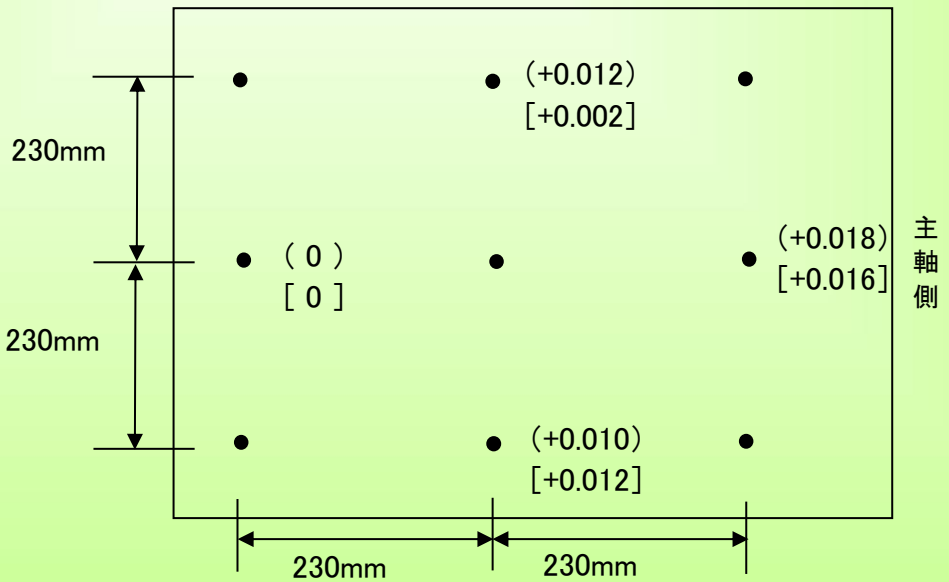

2026/10/30