
精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	エツキ	年式	2016	管理番号	H019694
型式	MS-V	測定者	山口	アシスタント	

振り回し(150ピッチ)

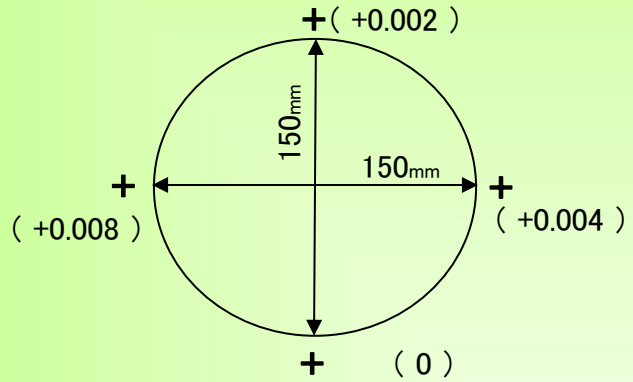



主軸振れ

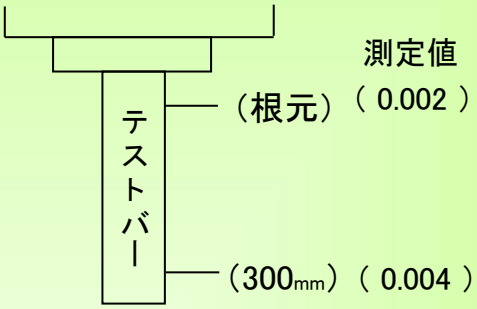


直角度

【YZ】測定値 (0.018)　【XZ】測定値 (0.026)　【X Y】測定値 (0.002)

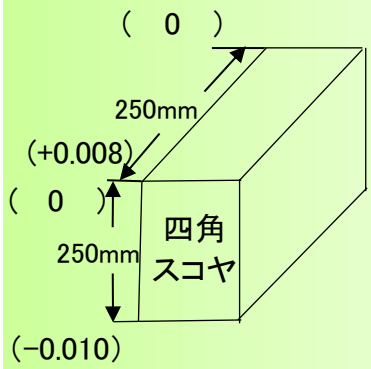


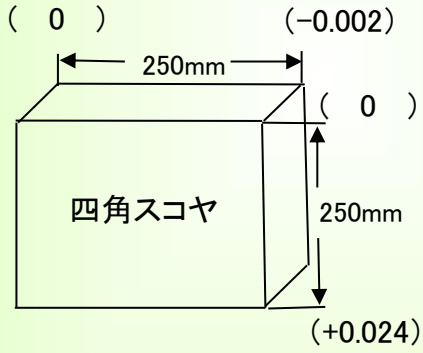

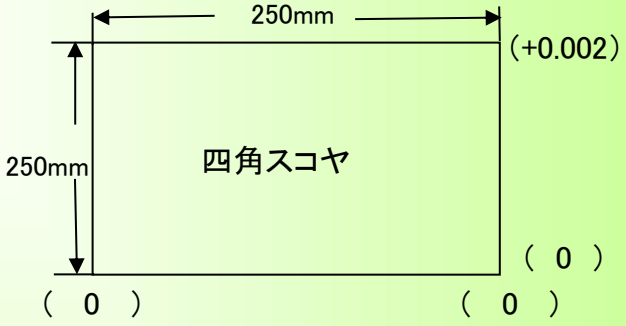

上面精度

※テーブルサイズ　1100×270

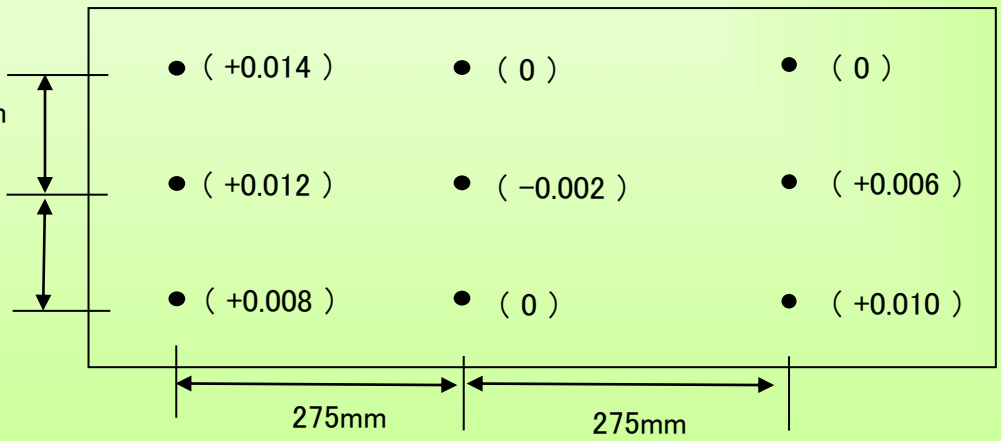

2026/10/28