



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2010年製	バーコード	P006937
型式	α -T14iFa	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


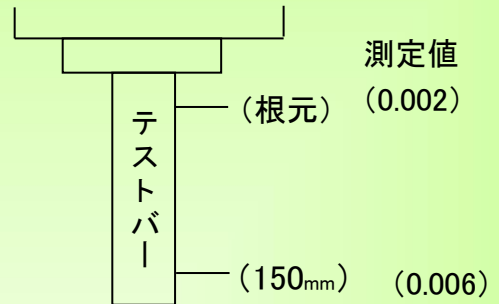
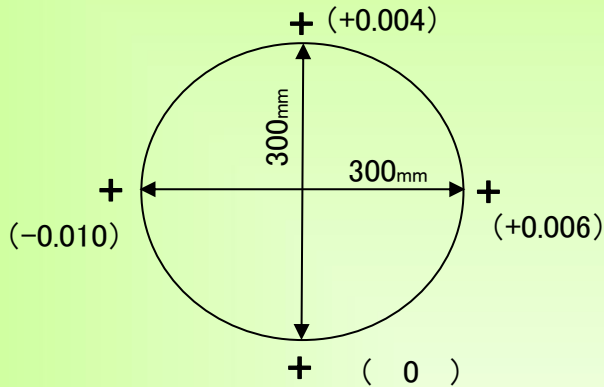


直角度

【YZ】測定値 (0.018)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.014)

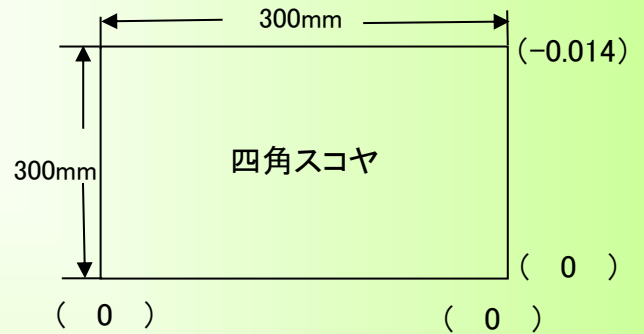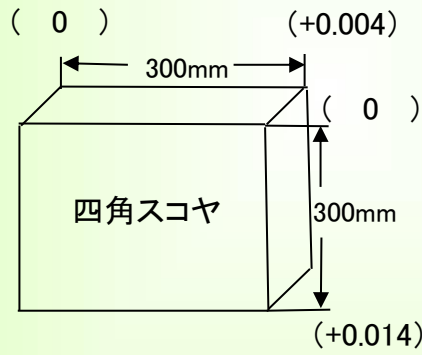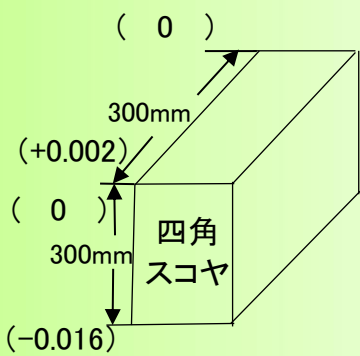

上面精度

※テーブルサイズ 650×400

