
精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	安田工業	年式	2003	管理番号	P009087
型式	MC430L	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

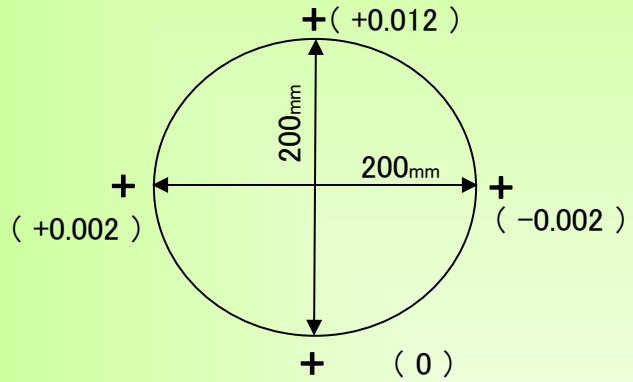



主軸振れ

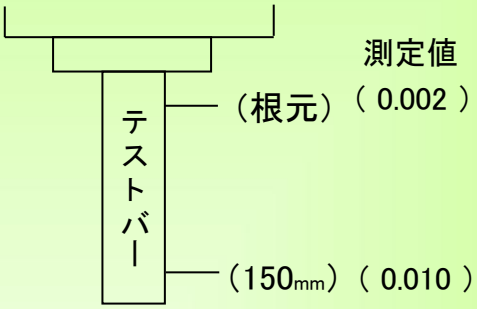


直角度

【YZ】測定値 (0.018)　【XZ】測定値 (0.004)　【X Y】測定値 (0.002)

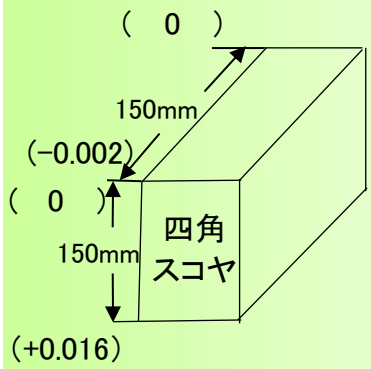


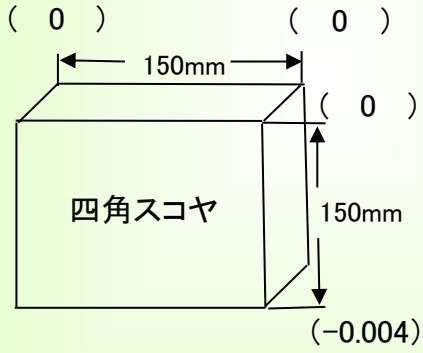

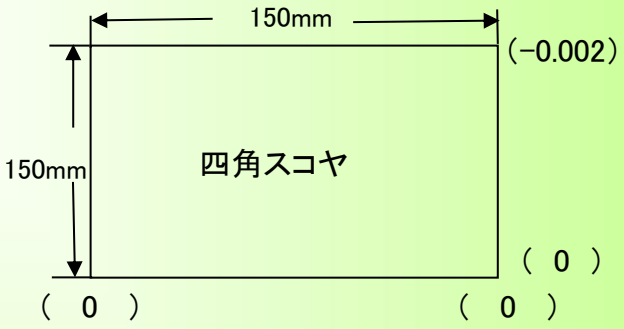

上面精度

※テーブルサイズ　400×350

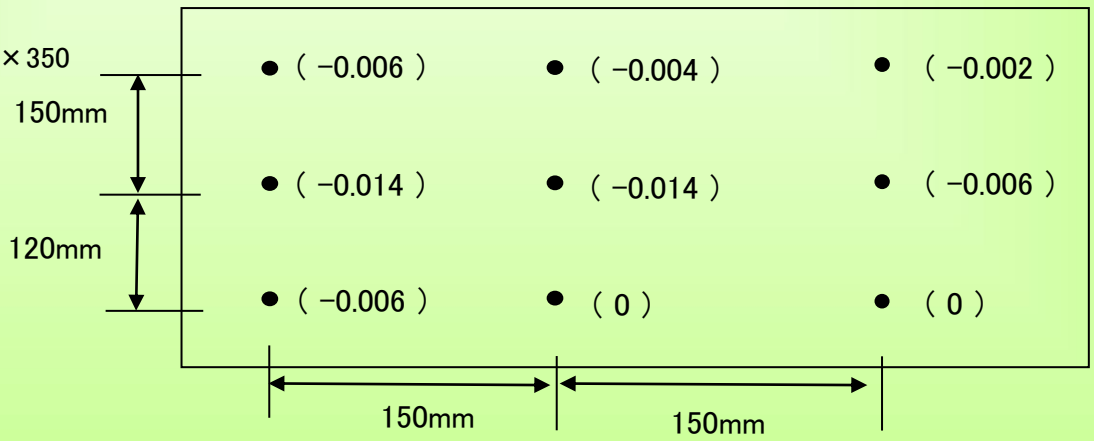

2026/11/6