精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2000.10	管理番号	P009354
型式	α-T14iBL	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

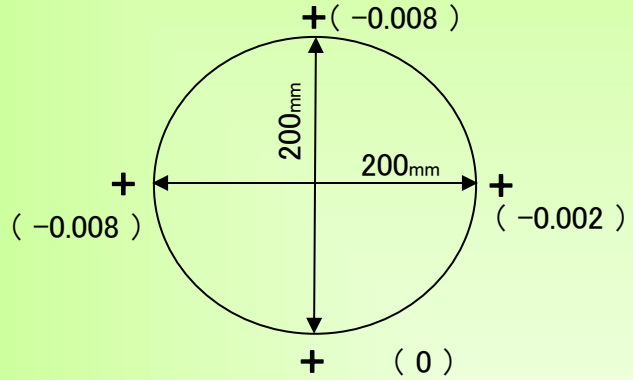

主軸振れ

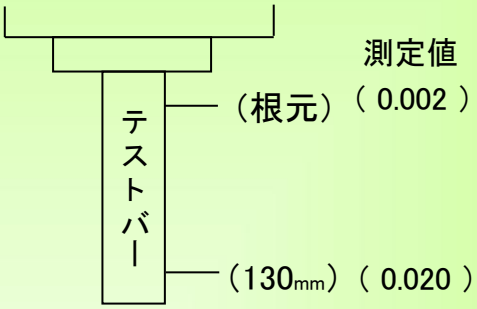

直角度

【YZ】測定値 (0.004)　【XZ】測定値 (0.010)　【X Y】測定値 (0.002)

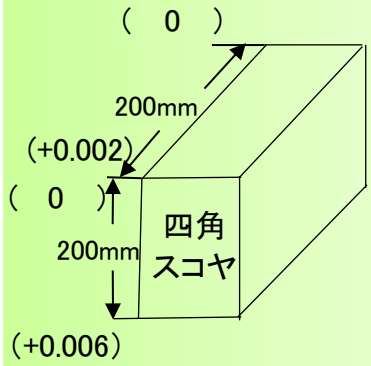

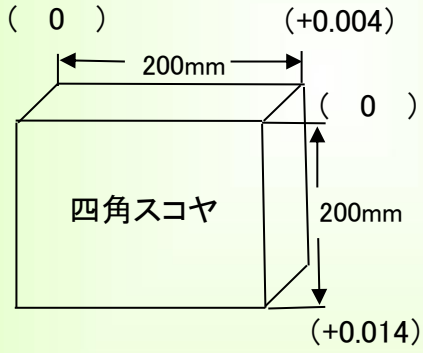

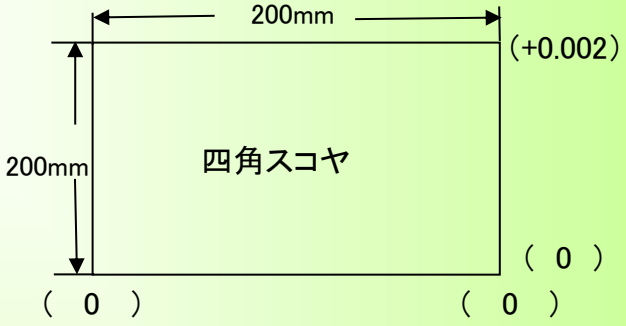

上面精度

【バックラッシュ測定】 X軸 0.002　Y軸 0.020　Z軸 0.002

※テーブルサイズ　410×850

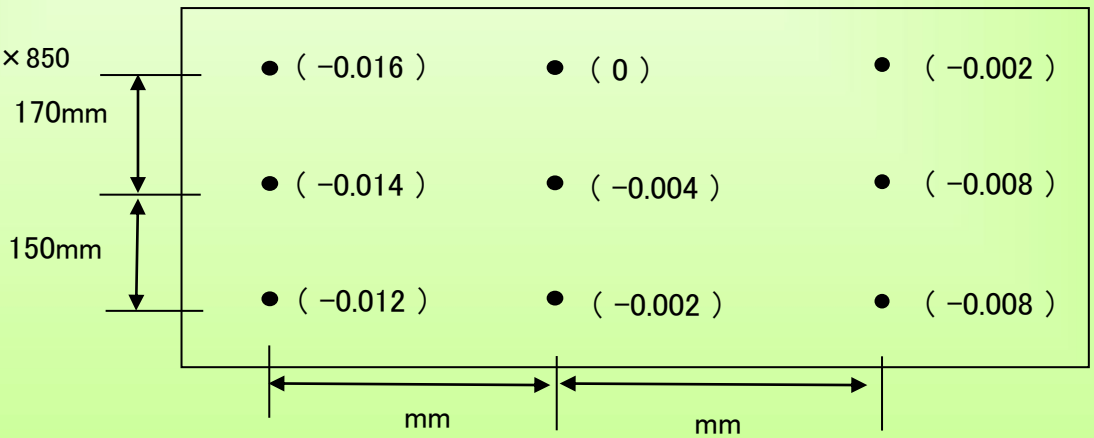

2026/11/4