


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2006年製	バーコード	P006815
型式	V22	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

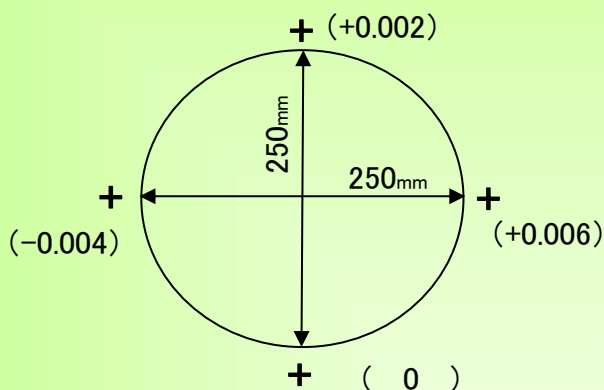

主軸振れ



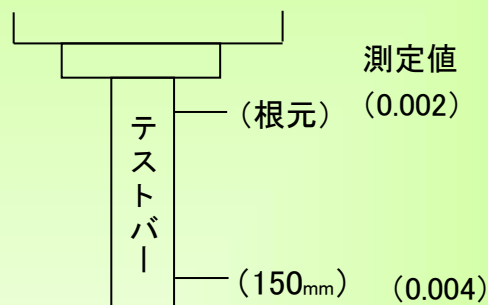


直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.008)

【X Y】測定値 (0.002)

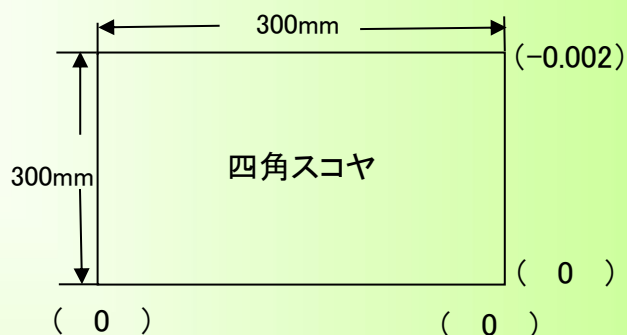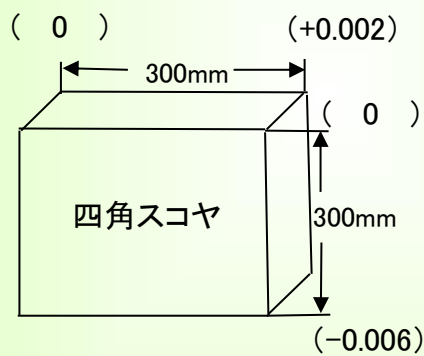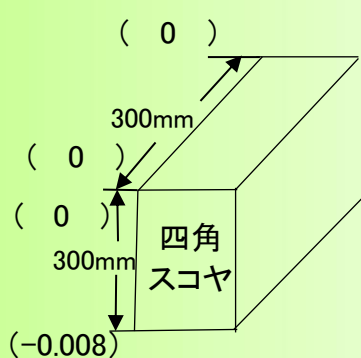

上面精度

※テーブルサイズ 450×350

