

精度測定検査表

Examination for precision list


測定日

2013. 2. 27


メーカー	牧野フライス	バーコード	P1768
型式	FNC-1710-A20		

精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	精度良好です
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

振り回し(300ピッチ)

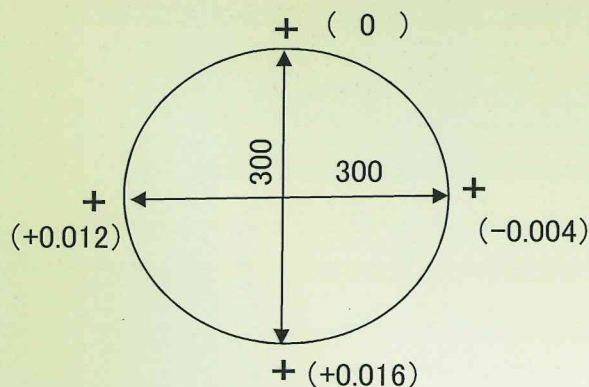

主軸振れ


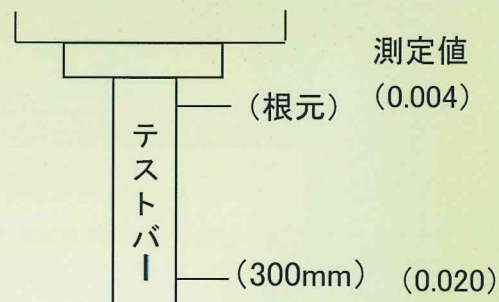


直角度

【Y Z】

【X Z】

【X Y】

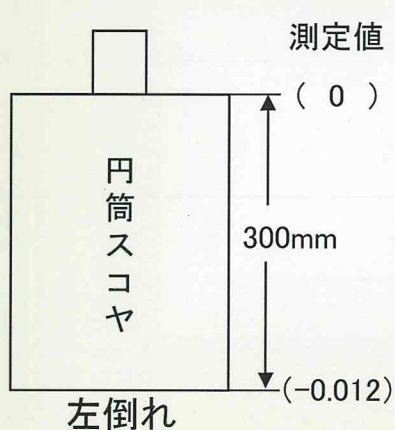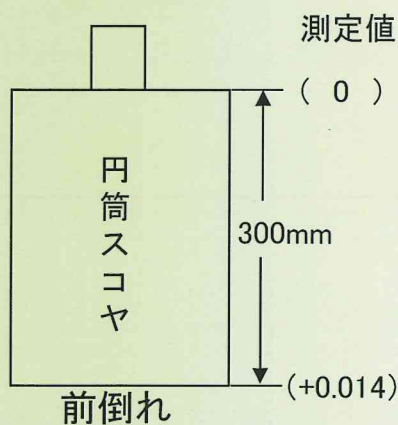

上面精度

