

精度測定検査表

Examination for precision list

測定日

2013. 2. 21

精度評価

コメント

A

0 ~ 0.02mm

B

0 ~ 0.03mm

C

0 ~ 0.04mm

D

0 ~ 0.05mm

メーカー

大隈豊和


バーコード

P2072


型式

MILLAC-852V

振り回し(300ピッチ)

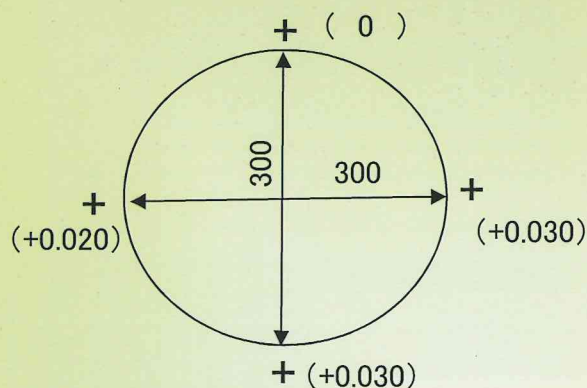


主軸振れ

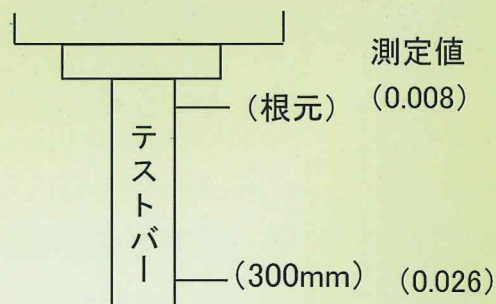


直角度


【Y Z】

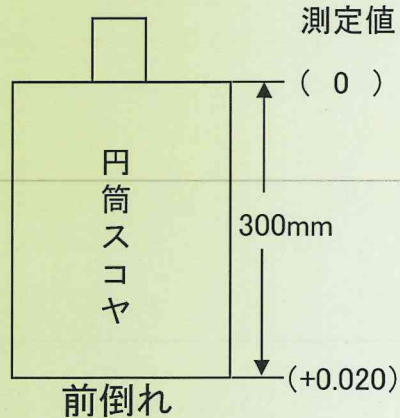

【X Z】

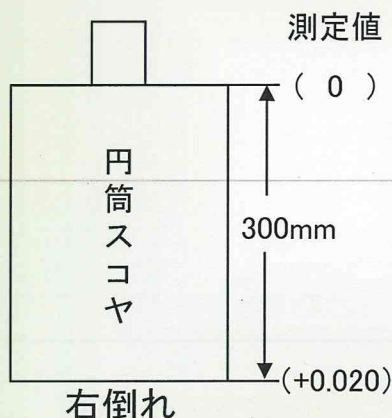

【X Y】

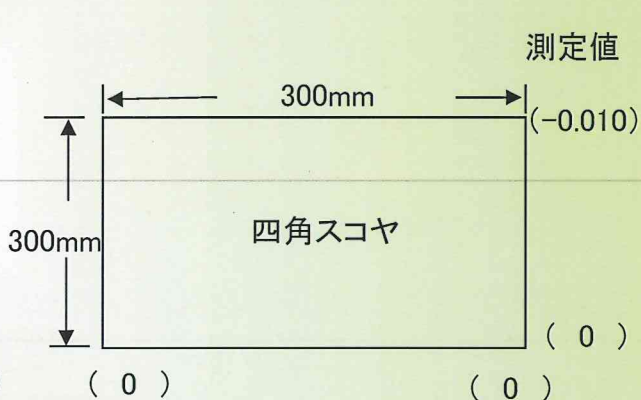

上面精度

