

精度測定検査表



Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2002年製	バーコード	P006162
型式	TC-31A	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

※各軸0.010位
蛇行があります


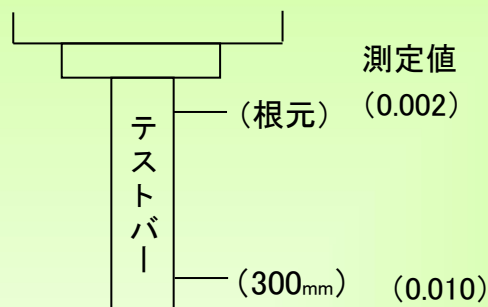
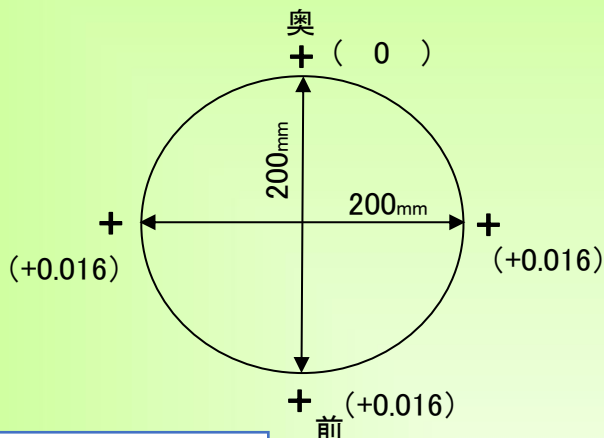


直角度

【YZ】測定値 (0.004)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.004)

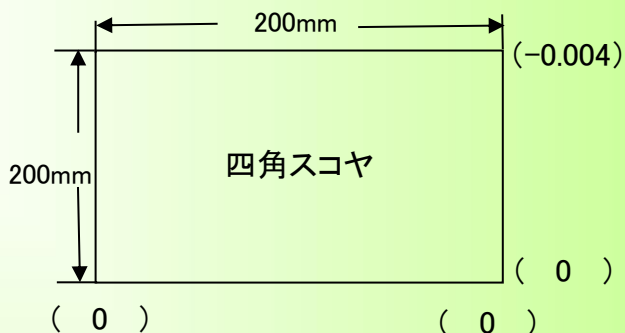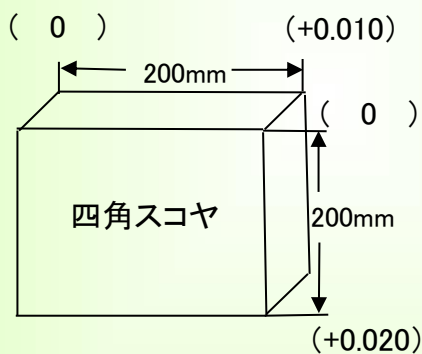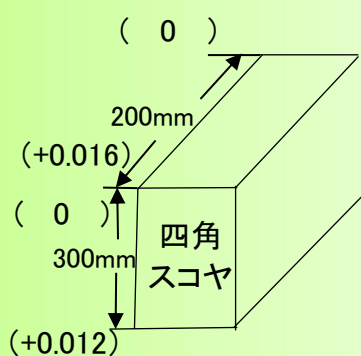

上面精度

※テーブルサイズ 500×270

