

精度測定検査表

Examination for precision list

測定日

2013. 3. 5

精度評価

コメント

A

0 ~ 0.02mm

B

0 ~ 0.03mm

C

0 ~ 0.04mm

D

0 ~ 0.05mm

精度良好です

メーカー

ファナック


バーコード

P2013


型式

a-T14iE

振り回し(300ピッチ)

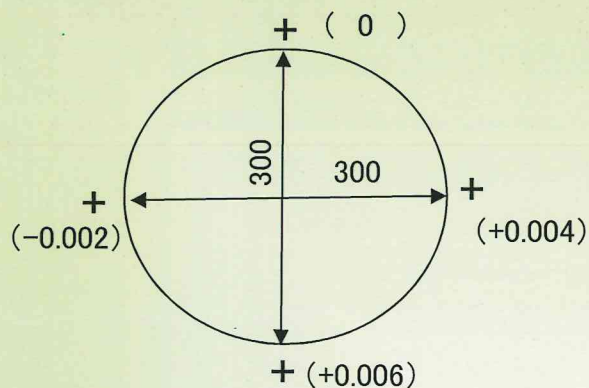


主軸振れ

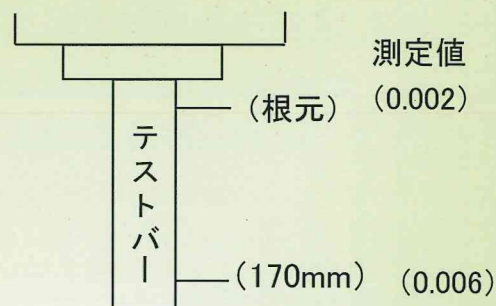


直角度

【Y Z】

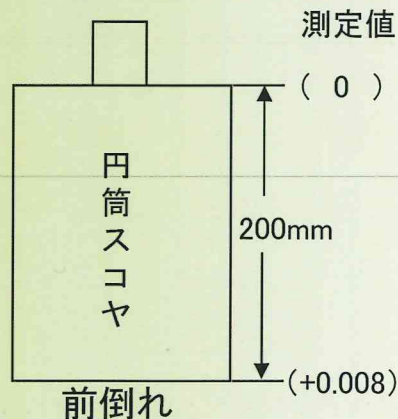


前倒れ

【X Z】

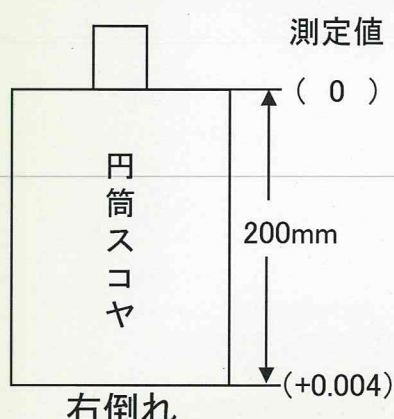

右倒れ

【X Y】

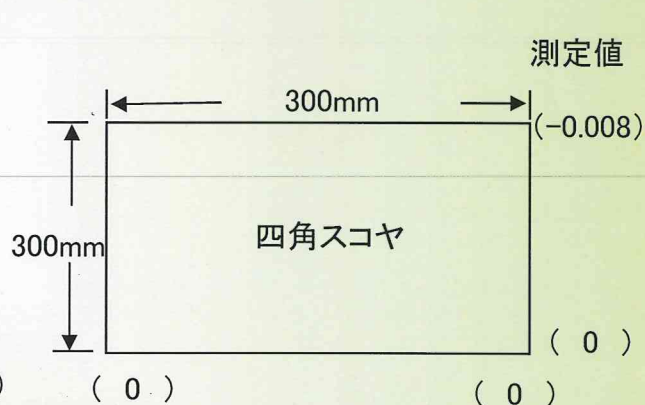

上面精度

