

精度測定検査表

Examination for precision list

測定日

2013. 4. 6

精度評価

コメント

A

0 ~ 0.02mm

B

0 ~ 0.03mm

C

0 ~ 0.04mm

D

0 ~ 0.05mm

精度良好です

メーカー

森精機

バーコード



P900139

型式

NH4000DCG

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

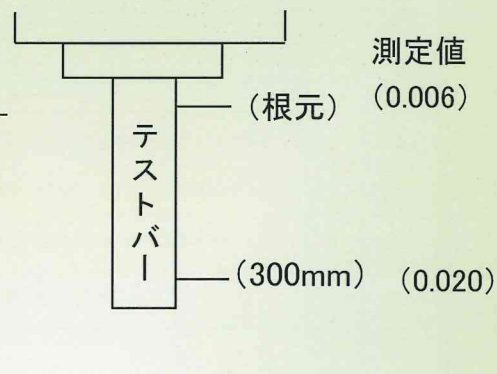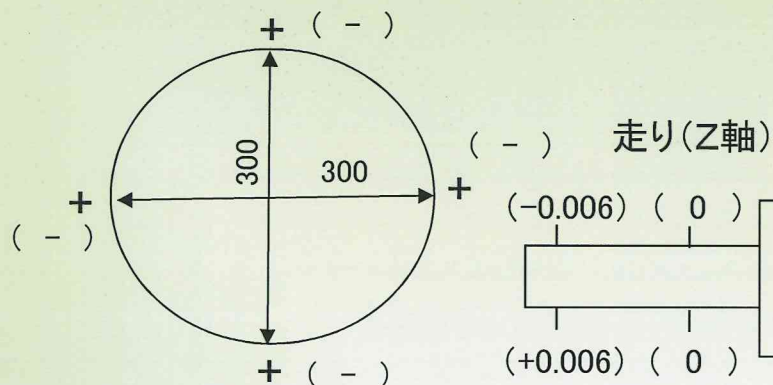




直角度

(1パレット)[2パレット]

【Y Z】

【X Z】

【X Y】

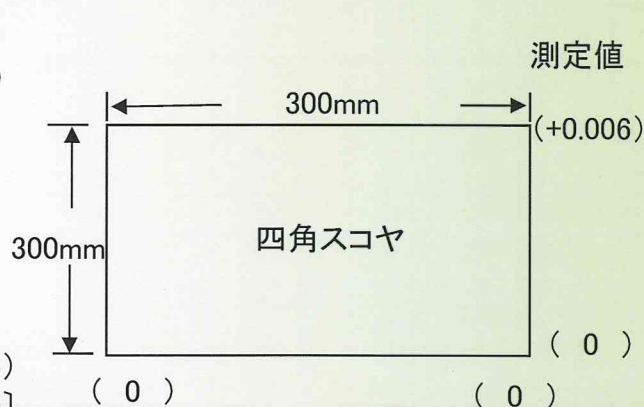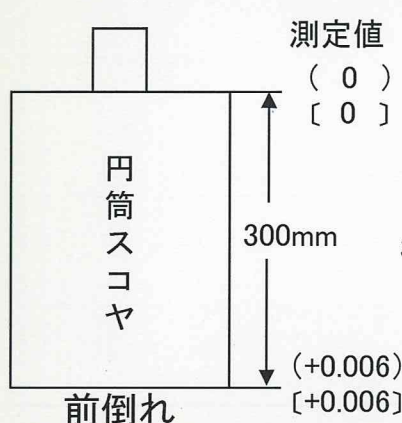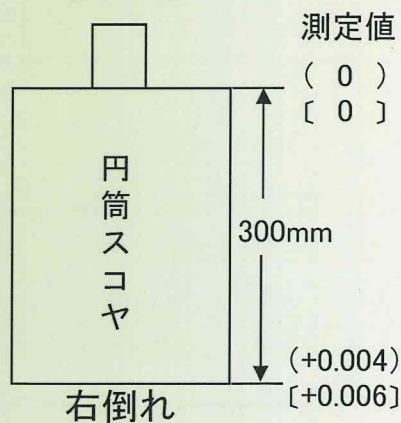

上面精度

