

精度測定検査表

Examination for precision list

測定日

2013. 8. 7

精度評価

コメント

A

0 ~ 0.02mm

B

0 ~ 0.03mm

C

0 ~ 0.04mm

D

0 ~ 0.05mm

精度良好です

メーカー

ヤマザキマザック

バーコード



P2419

型式

VCN-510C-HS

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


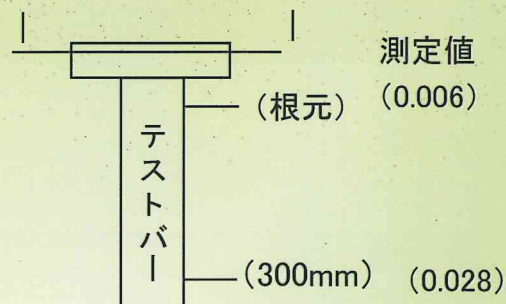
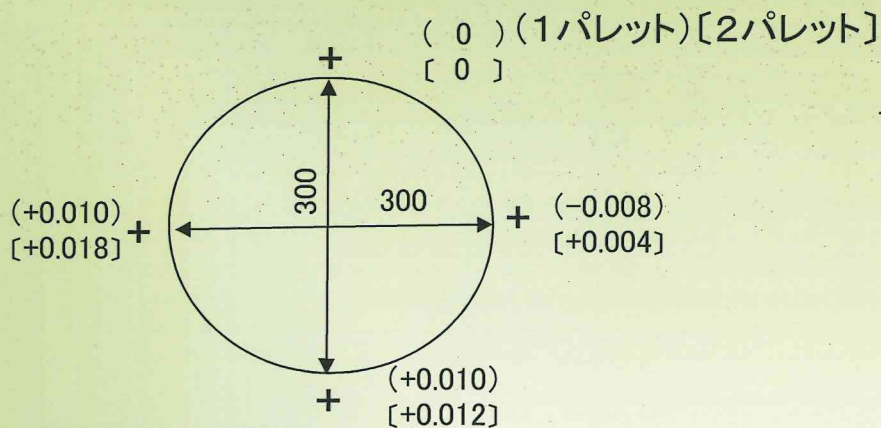


直角度

【Y Z】

【X Z】

【X Y】

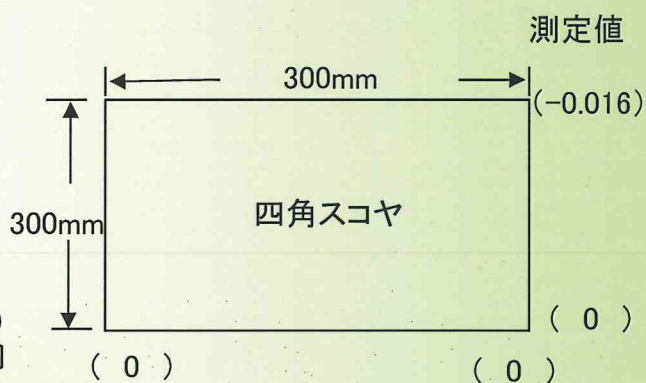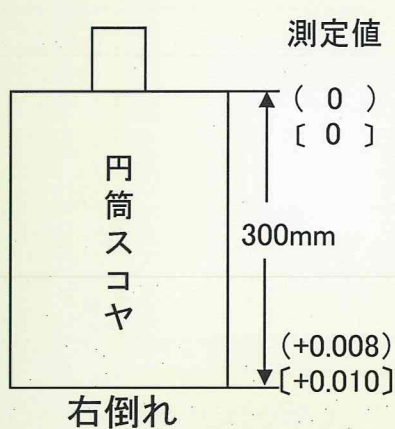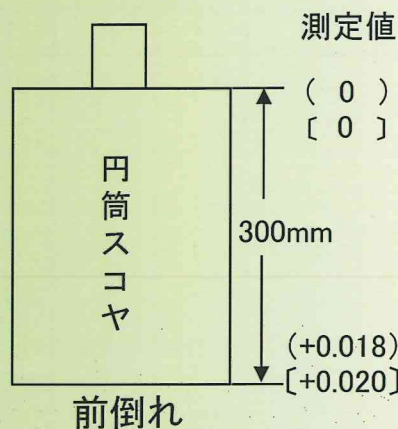

上面精度

